


Zimbra

marinagoulart@hfa.mil.br

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 65/2018

De : NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
<nlph@hotmail.com>

Seg, 07 de jan de 2019 14:03

 1 anexo

Assunto : PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 65/2018

Para : licitacao@hfa.mil.br

Bom dia!!

Venho por meio deste solicitar esclarecimento quanto ao PE 65/2018.

Itens 71 e 72: Fraldas Geriátricas Tamanho Grande.

Em edital está solicitando cintura de 115 à 150cm, sendo que nossa fralda da marca Essity veste cintura de 85 à 150cm. Ou seja, atendemos no quesito que veste cintura de até 150 cm conforme solicitado. Diante disto, meu pedido de esclarecimento é quanto a medida de circunferência descrita em edital. Ao participar não seremos desclassificados quanto à circunferência menor solicitada.

Itens 73 e 74: Fraldas Geriátricas Tamanho Extra Grande.

Em edital está solicitando cintura de 120 à 165cm, sendo que nossa fralda da marca Essity veste cintura de 110 à 165cm. Ou seja, atendemos no quesito que veste cintura de até 165 cm conforme solicitado. Diante disto, meu pedido de esclarecimento é quanto a medida de circunferência descrita em edital. Ao participar não seremos desclassificados quanto à circunferência menor solicitada.

Itens 11 e 12: Atadura crepom 100% algodão

Em edital está solicitando atadura de crepom 100% algodão. Gostaria de maiores esclarecimentos quanto a esta porcentagem de algodão pois há somente uma marca no mercado que fabrica atadura 100% algodão, as demais possuem composição mista com no mínimo 80% de algodão.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Angélica Dayane

SUPER MEDICAL

Razão Social: NL Produtos Hospitalares

CNPJ: 10.750.894/0001-90

Rua 1015 nº 881 Qd 119 Lt 28 Setor Pedro Ludovico

Goânia - Go

CEP:74.820.285

Telefone: (62) 3088- 5468 / 5462





MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Parte nº 8/2019/SEÇ LCTC

Brasília - DF, 07 de janeiro de 2019.

Do: Pregoeiro - Seção de Licitações

Ao: Sr Chefe da Seção Central de Abastecimento de Material Médico-Hospitalar do HFA

Via: SEI

Assunto: Análise de Pedido de Esclarecimento ao Edital.

Anexo: Pedido da empresa NL PRODUTOS HOSPITALARES (1401815).

1. Solicito a V. S^a analisar o Pedido de Esclarecimento anexo, avaliando se for o caso, possíveis alterações a serem implementadas no Edital.
2. Informo ainda, que o pregão 65/2018-HFA, foi publicado com previsão de abertura para 15 de janeiro de 2019 as 09 horas e que o prazo previsto para resposta ao pedido de esclarecimento é de 24 (vinte e quatro) horas após o seu recebimento.
3. Quaisquer dúvidas, entrar em contato com a TEN MARINA GOULART no ramal 2496.

MARINA RODRIGUES GOULART - 2º TEN OTT - EB
Adjunto da Seção de Licitações



Documento assinado eletronicamente por **Marina Rodrigues Goulart, Equipe de Apoio**, em 07/01/2019, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **1401819** e o código CRC **7091AC02**.



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E ESPORTE
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
SEÇÃO CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Parte nº 8/2019/SCAMMH

Brasília - DF, 08 de janeiro de 2019.

Do: Chefe da Seção Central de Abastecimento de Material Medico Hospitalar

A: Marina Rodrigues Goulart - 2º TEN OTT - EB

Assunto: Resposta **Parte nº 8/2019/SEÇ LCTC**

1. Versa o presente expediente sobre a resposta a parte **Parte nº 8/2019/SEÇ LCTC** referente ao Pedido de esclarecimento da empresa NL PRODUTOS HOSPITALARES, Pregão Eletrônico nº 65/2018.
2. Em atenção aos questionamentos, informo-vos que referente aos itens 71 e 72 (Fraldas Geriátricas Tamanho Grande) e itens 73 e 74 (Fraldas Geriátricas Tamanho Extra Grande) **não haverá desclassificação** quanto à circunferência menor solicitada, visto que atendem ao quesito da circunferência máxima (cintura de até 150/165 cm respectivamente).
3. Com relação aos itens 11 e 12 solicito a **correção do descritivo** do material no edital, **DE 100% algodão PARA no mínimo 70% algodão.**

ÂNGELA ALVES MENDES - 1º Ten OFT EB
Chefe da Seção Central de Abastecimento de Material Médico- Hospitalar



Documento assinado eletronicamente por **Angela Alves Mendes, Chefe**, em 08/01/2019, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **1402927** e o código CRC **C0210BF4**.

Zimbra

mena@hfa.mil.br

Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 65/2018

De : 1 Ten Barbosa <mena@hfa.mil.br>

Qua, 09 de jan de 2019 15:59

Assunto : Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 65/2018

1 anexo

Para : NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
<nlph@hotmail.com>**Sra Angélica Dayane - SUPER MEDICAL - NL Produtos Hospitalares**

Em atenção ao pedido de esclarecimento em relação ao Pregão eletrônico nº 65/2018-HFA, informo que o mesmo foi submetido à análise do Setor Técnico Requisitante, o qual pronunciou quanto aos questionamentos propostos conforme descrito a seguir:

- Em atenção aos questionamentos, informo-vos que referente aos itens 71 e 72 (Fraldas Geriátricas Tamanho Grande) e itens 73 e 74 (Fraldas Geriátricas Tamanho Extra Grande) **não haverá desclassificação** quanto à circunferência menor solicitada, visto que atendem ao quesito da circunferência máxima (cintura de até 150/165 cm respectivamente).

- Com relação aos itens 11 e 12 solicito a **correção do descritivo** do material no edital, **DE 100% algodão PARA no mínimo 70% algodão.**

Assim, mantida a decisão por parte do Setor Técnico requisitante após a devida análise, **não haverá desclassificação** quanto à circunferência menor solicitada, visto que atendem ao quesito da circunferência máxima (cintura de até 150/165 cm respectivamente).

Será promovida a alteração do descritivo dos itens 11 e 12 os quais passarão a constar com a seguinte descrição, após a substituição do Instrumento Convocatório no Portal comprasgovernamentais.gov.br:

Item 11 - ATADURA, MATERIAL CREPOM, no mínimo 70% ALGODÃO, LARGURA 10, COMPRIMENTO 450, QUANTIDADE FIOS 13, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL;

Item 12 - ATADURA, MATERIAL CREPOM, no mínimo 70% ALGODÃO, LARGURA 15, COMPRIMENTO 450, QUANTIDADE FIOS 13, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL.

MARINA RODRIGUES GOULART - 2º TEN OTT - EB

Adjunto da Seção de Licitações

De: "NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA." <nlph@hotmail.com>**Para:** licitacao@hfa.mil.br**Enviadas:** Segunda-feira, 7 de janeiro de 2019 14:03:48**Assunto:** PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 65/2018

Bom dia!!

Venho por meio deste solicitar esclarecimento quanto ao PE 65/2018.

Itens 71 e 72: Fraldas Geriátricas Tamanho Grande.

Em edital está solicitando cintura de 115 à 150cm, sendo que nossa fralda da marca Essity veste cintura de 85 à 150cm. Ou seja, atendemos no quesito que veste cintura de até 150 cm conforme solicitado. Diante disto, meu pedido de esclarecimento é quanto a medida de circunferência descrita em edital. Ao participar não seremos desclassificados quanto à circunferência menor solicitada.

Itens 73 e 74: Fraldas Geriátricas Tamanho Extra Grande.

Em edital está solicitando cintura de 120 à 165cm, sendo que nossa fralda da marca Essity veste cintura de 110 à 165cm. Ou seja, atendemos no quesito que veste cintura de até 165 cm conforme solicitado. Diante disto, meu pedido de esclarecimento é quanto a medida de circunferência descrita em edital. Ao participar não seremos desclassificados quanto à circunferência menor solicitada.

Itens 11 e 12: Atadura crepom 100% algodão

Em edital está solicitando atadura de crepom 100% algodão. Gostaria de maiores esclarecimentos quanto a esta porcentagem de algodão pois há somente uma marca no mercado que fabrica atadura 100% algodão, as demais possuem composição mista com no mínimo 80% de algodão.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Angélica Dayane

SUPER MEDICAL

Razão Social: NL Produtos Hospitalares

CNPJ: 10.750.894/0001-90

Rua 1015 nº 881 Qd 119 Lt 28 Setor Pedro Ludovico

Goiânia - Go

CEP:74.820.285

Telefone: (62) 3088- 5468 / 5462



Zimbra

mena@hfa.mil.br

Re: Questionamento - Pregão 65/2018 UASG 112408 Abertura 15-01 às 09:00 horas

De : 1 2 2 2 Ten Barbosa <mena@hfa.mil.br>

Qui, 10 de jan de 2019 16:08

Assunto : Re: Questionamento - Pregão 65/2018 UASG 112408 Abertura 15-01 às 09:00 horas

📎 1 anexo

Para : SERVICIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE <sac@lacrefix.com.br>

Sr Milton Cesar Fernandes - Lacrefix

Em atenção ao pedido de esclarecimento enviado, informo que o foi enviado ao Setor Técnico Requisitante para fim de apreciação de solução.

Att.

RICARDO BARBOSA MENA - 1º Ten - Equipe de Apoio

De: "SERVICIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE" <sac@lacrefix.com.br>

Para: licitacao@hfa.mil.br

Enviadas: Quinta-feira, 10 de janeiro de 2019 14:45:57

Assunto: Questionamento - Pregão 65/2018 UASG 112408 Abertura 15-01 às 09:00 horas

Sr. Pregoeiro,
Boa tarde!

Poderia por gentileza me informar qual especificação posso aceitar para o Item 84 Lacre de Segurança, pois o Edital não especifica o tamanho do Lacre, mas no Portal do ComprasNET a descrição refere-se ao Lacre abaixo:

MINISTÉRIO DA DEFESA
Secretaria de Organização Institucional
Hospital das Forças Armadas

The screenshot shows the ComprasNET portal interface. At the top, there's a header for 'Portal de Compras do Governo Federal - Comprasnet' and 'MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO'. Below this, there's a table of items. Item 84 is highlighted, with a detailed description window open. The description for Item 84 is: 'Lacre Segurança, Material Plástico, Comprimento 16 cm, Tipo Espinha de Peixe, Características Adicionais Numerado, Cor Azul'. The table also shows items 85 (Lâmina Laboratório) and 86 (Lâmina Bisturi).

Aguardo confirmação para Lançar a proposta.

Milton Cesar Fernandes ME
CNPJ 07.245.369/0001-03

Dúvidas? Fale comigo pelo Whatsapp. É só [clique aqui](#) :)



Célia G. Ferreira
Auxiliar de Vendas
sac@lacrefix.com.br

(31)3629- 1264
lacrefix.com.br

A Lacrefix lacs de segurança LTDA – EPP possui seu sistema de gestão da qualidade certificado conforme requisitos da norma NBR ISO 9001, pelo organismo BRTUV Avaliações de Qualidade Ltda.

A proposta anexa a este e-mail, foi analisada criticamente e aprovada pelo emitente do mesmo. Esse e-mail será mantido como informação documentada.

Jo. 3.16: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna"



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES DO HFA

Parte nº 18/2019/SEÇ LCTC

Brasília - DF, 10 de janeiro de 2019.

Do: Pregoeiro - Seção de Licitações

Ao: Sr Chefe da Seção Central de Abastecimento de Material Médico-Hospitalar do HFA

Via: SEI

Assunto: Assunto: Análise de Pedido de Esclarecimento Edital PE 65/2018-HFA.

Anexos: Pedido de esclarecimento Lacrelix (1408325).

1. Solicito a V. S^a analisar o Pedido de esclarecimento anexo, enviado pela empresa LACREFIX LACRES DE SEGURANÇA LTDA.
2. Informo ainda, que o pregão 65/2018-HFA, foi publicado com previsão de abertura para 15 de janeiro de 2019 as 09 horas e que o prazo previsto para resposta ao pedido de impugnação é de 24 (vinte e quatro) horas após o seu recebimento.
3. Quaisquer dúvidas, entrar em contato com a TEN MARINA GOULART no ramal 2496.

MARINA RODRIGUES GOULART - 2º TEN OTT - EB
Adjunto da Seção de Licitações



Documento assinado eletronicamente por **Marina Rodrigues Goulart, Equipe de Apoio**, em 10/01/2019, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **1408330** e o código CRC **FEEB06F1**.

Zimbra

mena@hfa.mil.br

Re: Pedido de esclarecimento PE 65/2018 - PC60550.016816/2018-98.

De : 1 Ten Barbosa <mena@hfa.mil.br>

Qui, 10 de jan de 2019 16:15

Assunto : Re: Pedido de esclarecimento PE 65/2018 -
PC60550.016816/2018-98.

1 anexo

Para : Pregão 2 <pregao2@polarfix.com.br>

Sra Camila Santos - Polarfix Essencial a Saúde

Em atenção ao pedido de esclarecimento, informo que o mesmo foi enviado ao Setor Técnico Requisitante para fim de apreciação e solução.

Att.

RICARDO BARBOSA MENA - 1º Ten - Equipe de Apoio

De: "Pregão 2" <pregao2@polarfix.com.br>**Para:** licitacao@hfa.mil.br**Enviadas:** Quinta-feira, 10 de janeiro de 2019 15:51:40**Assunto:** Pedido de esclarecimento PE 65/2018 - PC60550.016816/2018-98.

Sr. Pregoeiro, boa tarde!

Em análise ao edital do PE 65/2018, cujo o objeto é eventual aquisição de material de consumo de saúde (descartáveis) para a Seção Central de Abastecimento de Material Médico Hospitalar, identificamos a necessidade de esclarecimento acerca do item 16.

AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, TIPO ABERTURA ATRÁS, GRAMATURA 60, COMPRIMENTO MÍNIMO 1,40 M, TIPO MANGA LONGA, COMPRIMENTO MÍNIMO DA MANGA 0,65 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL P/ FLUÍDOS, PERMEÁVEL AO AR, MATERIAL SMS, POLIPROPILENO, TIPO USO DESCARTÁVEL.

No descritivo não menciona se é estéril ou não estéril, embalagem individual ou pacote com 10 ?

Aguardo retorno do esclarecimento, para andamento de nossa participação no processo licitatório.

Atenciosamente,

--

**Camila Santos**

Licitação

Fone: 11 4512 8626

Email: pregao2@polarfix.com.br

www.polarfix.com.br



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES DO HFA

Parte nº 19/2019/SEÇ LCTC

Brasília - DF, 10 de janeiro de 2019.

Do: Pregoeiro - Seção de Licitações

Ao: Sr Chefe da Seção Central de Abastecimento de Material Médico-Hospitalar do HFA

Via: SEI

Assunto: Assunto: Análise de Pedido de Esclarecimento Edital PE 65/2018-HFA.

Anexos: Pedido de esclarecimento POLARFIX (1408355).

1. Solicito a V. S^a analisar o Pedido de esclarecimento anexo, enviado pela empresa POLARFIX ESSENCIAL À SAÚDE.
2. Informo ainda, que o pregão 65/2018-HFA, foi publicado com previsão de abertura para 15 de janeiro de 2019 as 09 horas e que o prazo previsto para resposta ao pedido de impugnação é de 24 (vinte e quatro) horas após o seu recebimento.
3. Quaisquer dúvidas, entrar em contato com a TEN MARINA GOULART no ramal 2496.

MARINA RODRIGUES GOULART - 2º TEN OTT - EB
Adjunto da Seção de Licitações



Documento assinado eletronicamente por **Marina Rodrigues Goulart, Equipe de Apoio**, em 10/01/2019, às 16:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **1408357** e o código CRC **9A7897A6**.

Zimbra

mena@hfa.mil.br

Re: Esclarecimento do PE: 65/2018

De : 1 Ten Barbosa <mena@hfa.mil.br>

Sex, 11 de jan de 2019 08:20

Assunto : Re: Esclarecimento do PE: 65/2018

1 anexo

Para : licitacao01@zammi.com.br

Sra Danielle Santos - ZAMMI-LABCOR.

Em atenção ao presente pedido de esclarecimento, exarado por essa empresa, informo que o mesmo foi encaminhado ao Setor Técnico Requisitante para fim de apreciação e solução.

Att.

Ricardo Barbosa Mena - 1º Ten - Equipe de Apoio

De: "Danielle Santos - LICITAÇÃO ZAMMI-LABCOR" <licitacao01@zammi.com.br>**Para:** licitacao@hfa.mil.br**Enviadas:** Quinta-feira, 10 de janeiro de 2019 16:55:09**Assunto:** Esclarecimento do PE: 65/2018

Senhores, boa tarde,

Gostaria de esclarecimento quanto ao número e os modelos dos cabos exigidos no edital para os itens 82 e 83.

Para a participação precisamos de padronização?

Aguardamos retorno.

Atenciosamente,

--



Preserve o meio ambiente. Antes de imprimir esta mensagem, verifique se é realmente necessária.

Danielle Santos*Departamento de Licitações / Comercial*

✉ Licitacao01@zammi.com.br / Comercial@zammi.com.br

Daniellesantos@zammi.com.br

☎ 2677-1579



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES DO HFA

Parte nº 20/2019/SEÇ LCTC

Brasília - DF, 11 de janeiro de 2019.

Do: Pregoeiro - Seção de Licitações

Ao: Sr Chefe da Seção Central de Abastecimento de Material Médico-Hospitalar do HFA

Via: SEI

Assunto: Assunto: Análise de Pedido de Esclarecimento Edital PE 65/2018-HFA.

Anexos: Pedido de esclarecimento Zammi Labcor (1408923).

1. Solicito a V. S^a analisar o Pedido de esclarecimento anexo, enviado pela empresa Zammi Labcor.
2. Informo ainda, que o pregão 65/2018-HFA, foi publicado com previsão de abertura para 15 de janeiro de 2019 as 09 horas e que o prazo previsto para resposta ao pedido de impugnação é de 24 (vinte e quatro) horas após o seu recebimento.
3. Quaisquer dúvidas, entrar em contato com a TEN MARINA GOULART no ramal 2496.

MARINA RODRIGUES GOULART - 2º TEN OTT - EB
Adjunto da Seção de Licitações



Documento assinado eletronicamente por **Marina Rodrigues Goulart, Equipe de Apoio**, em 11/01/2019, às 08:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **1408927** e o código CRC **CF9A9E1D**.

Zimbra

mena@hfa.mil.br

Re: Pedido de Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2018 - HOSP DAS FORCAS ARMADAS

De : 1 Ten Barbosa <mena@hfa.mil.br>

Sex, 11 de jan de 2019 08:24

Assunto : Re: Pedido de Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2018 - HOSP DAS FORCAS ARMADAS**Para :** Fran Araujo <Fran_Araujo@edwards.com>

Sra Fran Araujo - CRITICAL CARE

Em atenção ao presente pedido de esclarecimento referente ao PE 65/2018-HFA, exarado por essa empresa, informo que o mesmo foi encaminhado ao Setor Técnico Requisitante para fim de apreciação e solução.

Att.

Ricardo Barbosa Mena - 1º Ten - Equipe de Apoio

De: "Fran Araujo" <Fran_Araujo@edwards.com>**Para:** licitacao@hfa.mil.br**Enviadas:** Quinta-feira, 10 de janeiro de 2019 18:05:36**Assunto:** Pedido de Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2018 - HOSP DAS FORCAS ARMADAS

Prezados, boa tarde,

Solicito esclarecimento referente ao **Pregão Eletrônico nº 65/2018 - Processo Administrativo Nº 60550.016816/2018-98:**

- **Item [82]:** *KIT TRANSDUTOR DESCARTÁVEL DUPLO COM CONECTORES VALVULADOS DO SISTEMA FECHADO SEM AGULHAS ACOPLADO NA SAÍDA DAS TORNEIRAS PARA COLETA DE SANGUE...*

Solicito que seja confirmado a quantidade de cabos necessários a empresa vencedora deverá fornecer e quais os modelos/marca dos monitores?

Aguardo retorno o mais breve possível.

Obrigada.

Fran Araújo

Executiva de Vendas interna Critical Care

Edwards Lifesciences

Rua Verbo Divino, 1547 – 1º andar

04719-002 - São Paulo - SP - Brasil

Ph Brazil: 55 11 5567-5241

Fran_Araujo@edwards.com
edwards.com/br

This message contains information which may be confidential and privileged. Unless you are the intended addressee (or authorized to receive for the intended addressee), you may not use, copy or disclose to anyone the message or any information contained in the message. If you have received the message in error, please advise the sender by reply and delete the message. To the extent contractual confidentiality obligations exist, this message and all information transmitted with it are designated "Confidential".



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES DO HFA

Parte nº 21/2019/SEÇ LCTC

Brasília - DF, 11 de janeiro de 2019.

Do: Pregoeiro - Seção de Licitações

Ao: Sr Chefe da Seção Central de Abastecimento de Material Médico-Hospitalar do HFA

Via: SEI

Assunto: Assunto: Análise de Pedido de Esclarecimento Edital PE 65/2018-HFA.

Anexos: Pedido de esclarecimento Critical Care (1408934).

1. Solicito a V. S^a analisar o Pedido de esclarecimento anexo, enviado pela empresa Critical Care.
2. Informo ainda, que o pregão 65/2018-HFA, foi publicado com previsão de abertura para 15 de janeiro de 2019 as 09 horas e que o prazo previsto para resposta ao pedido de impugnação é de 24 (vinte e quatro) horas após o seu recebimento.
3. Quaisquer dúvidas, entrar em contato com a TEN MARINA GOULART no ramal 2496.

MARINA RODRIGUES GOULART - 2º TEN OTT - EB
Adjunto da Seção de Licitações



Documento assinado eletronicamente por **Marina Rodrigues Goulart, Equipe de Apoio**, em 11/01/2019, às 08:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **1408935** e o código CRC **E3A8F6CE**.


Zimbra

klsantos@hfa.mil.br

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 65/2018 CAMPO OPERATÓRIO

De : NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. <nlyph@hotmail.com>

Seg, 14 de jan de 2019 16:00

Assunto : PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 65/2018 CAMPO OPERATÓRIO 1 anexo**Para :** licitacao@hfa.mil.br

Boa tarde!!

Venho por meio deste solicitar esclarecimento quanto ao PE 65/2018.

Itens 21 e 22: Campo Operatório.

Em edital está solicitando campo operatório com fio radiopaco 45x50 estéril (pct/5 und), sendo que os pacotes de campo operatório estéril fornecido pelas marcas são 25x28. A medida 45x50 (medida não estéril) após lavado e desengomado se torna o tamanho 25x28. Portanto, solicito esclarecimento quanto ao tamanho deste item, pois não há campo estéril no tamanho solicitado de 45x50.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Angélica Dayane
SUPER MEDICAL

Razão Social: NL Produtos Hospitalares

CNPJ: 10.750.894/0001-90

Rua 1015 nº 881 Qd 119 Lt 28 Setor Pedro Ludovico

Goiânia - Go

CEP:74.820.285

Telefone: (62) 3088- 5468 / 5462





MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
SEÇÃO CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Parte nº 22/2019/SCAMMH

Brasília - DF, 15 de janeiro de 2019.

Do: Chefe da Seção Central de Abastecimento de Material Medico Hospitalar

Ao : Pregoeiro - Seção de Licitações

Assunto: Resposta à Parte nº 27/2019/SEÇ LCTC

1. Versa o presente expediente sobre o pedido de esclarecimento das empresas licitantes referentes ao Edital do Pregão Eletrônico nº 65/2018-HFA.
2. Com relação ao pedido de esclarecimento da Empresa **NL Produtos Hospitalares** (Parte nº 27), referente ao descritivo dos itens 21 e 22, solicito a **correção do descritivo** do material no edital, **DE "45CMx50CM" PARA "25CMx28CM"**.

ÂNGELA ALVES MENDES - 1º Ten OFT EB
Chefe da Seção Central de Abastecimento de Material Médico- Hospitalar



Documento assinado eletronicamente por **Angela Alves Mendes, Chefe**, em 15/01/2019, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **1413217** e o código CRC **5EC0074E**.



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Parte nº 34/2019/SEÇ LCTC

Brasília - DF, 17 de janeiro de 2019.

Do: Pregoeiro SC Klinger

A: Sra. Chefe da Seção de Pesquisa de Preços do HFA

Via: SEI

Assunto: Comprovação de preços praticados no Pregão Eletrônico nº 62/2018 - Material de consumo de saúde (descartáveis)

1. Solicito a V. S^a, verificar a possibilidade de realizar a pesquisa de preços referente aos itens 21 e 22 (cota reservada e principal) do presente Pregão Eletrônico.
2. Ressalta-se que a presente solicitação tem como fundamento o pedido de esclarecimento enviado pela empresa SUPERMEDICAL (1412829), o qual foi acatado pela Seção Central de Abastecimento de Material Médico- Hospitalar (1413217).
3. Conforme informado, o descritivo dos itens supracitados constarão com a seguinte descrição:
 - CAMPO OPERATÓRIO, TECIDO 100% ALGODÃO, C/ FIO RADIOPACO, 25CMx28CM, 15 FIOS/CM2, ACABAMENTO C/PONTO OVERLOCK, BRANCA, 04 CAMADAS, CANTOS ARREDONDADOS, CADARÇO DUPLO MÍNIMO 18 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL (PACOTE C/ 05 UNIDADES)
4. Outrossim, informo a V. S^a que, em caso de dúvidas, estarei à disposição no ramal 2407.

Atenciosamente,

KLINGER SANTIAGO DOS SANTOS
Pregoeiro



Documento assinado eletronicamente por **Klinger Santiago dos Santos, Pregoeiro(a)**, em 17/01/2019, às 14:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **1418124** e o código CRC **82BD8DEC**.

Pedido Esclarecimento Pregão Eletrônico nº 65/2018

De : Vita Medical - Thiago <thiago@vitamedical.com.br>

Qui, 24 de jan de 2019 12:36

Assunto : Pedido Esclarecimento Pregão Eletrônico nº 65/2018

Para : licitacao@hfa.mil.br

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Bom dia!


Prezados, conforme item "22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO" do edital do Pregão 65/2018, solicitamos esclarecimento acerca do item 03

O descritivo do edital, solicita o item 03 o seguinte :" *ADESIVO DE USO MÉDICO-HOSPITALAR. PELÍCULA ADESIVA, MATERIAL POLIURETANO, PERMEABILIDADE PERMEÁVEL A GASES E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO EXTERNA DE CÂNULAS, SONDAS E CATETERES, PROPORCIONA UM SEGURO POSICIONAMENTO E FIXAÇÃO NA PELE. SUPERFÍCIE ADESIVA HIPOALERGÊNICA QUE NÃO PROVOCA LESÕES. TAMANHO 10 CM X 5,5 CM OU APROXIMADAMENTE*"

Temos produtos que atendem completamente ao descritivo. Entretanto, o tamanho solicitado " *TAMANHO 10 CM X 5,5 CM OU APROXIMADAMENTE*", entendemos ser um tamanho pouco usual no mercado. Normalmente esses produtos são de tamanho: a) "10cm X 12cm" ou b) "06cm X 07cm"... Ambos para fixação secundária, conforme solicitado.

Dentre os tamanhos informados, gostaríamos de saber se podemos cotar algum desses e qual seria o melhor para o pleito desejado ao hospital, caso haja possibilidade para os tamanhos acima informados

Desde já ficamos à disposição



Remetente notificado por
[Mailtrack](#)



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Parte nº 56/2019/SEÇ LCTC

Brasília - DF, 28 de janeiro de 2019.

Do: Pregoeiro - SC Klinger - Seção de Licitações

Ao: Sr Chefe da Seção de Pesquisa de Preços do HFA

Assunto: Esclarecimento Pregão 65/2018- HFA

Anexo: Pedido de Esclarecimento WINNER INDUSTRIA (1434150)

1. Solicito a V. S^a analisar o Pedido de esclarecimento anexo, enviado pela empresa WINNER INDUSTRIA.

2. Peço urgência no envio da análise supracitada, tendo em vista que a abertura do pregão está agendada para o dia 05/02, de forma a evitar possíveis impugnações.

3. Quaisquer dúvidas, entrar em contato com o SC KLINGER no ramal 2407.

Atenciosamente,

KLINGER SANTIAGO DOS SANTOS

Pregoeiro



Documento assinado eletronicamente por **Klinger Santiago dos Santos, Pregoeiro(a)**, em 28/01/2019, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **1434148** e o código CRC **D08BE000**.

esclarecimento

De : Elisangela Guedes <elisangela.winnerbrasil@gmail.com>

Seg, 28 de jan de 2019 16:12

Assunto : esclarecimento

Para : licitacao@hfa.mil.br

Boa tarde,

me chamo Elisangela Guedes, responsável por licitação da empresa Winner Indústria de Descartáveis Ltda. Estou com o edital n 65/2018 UASG 112408 e nos itens 15 e 16 os valores estão muito abaixo do valor de mercado

No item 15 AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, TIPO EMPOLIPROPILENO, ALTURA MÍNIMA 1,40M, GRAMATURA 50, TIPO MANGA MANGA LONGA, TIPO PUNHO PUNHO COM ELÁSTICO, TAMANHO TAMANHO ÚNICO. - REGISTRO NA ANVISA o valor R\$ 3,16, com esse valor vocês não receberam a gramatura solicitada, um avental não estéril gr 50 é no minimo R\$ 7,00

Item 16AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, TIPO ABERTURA ATRÁS, GRAMATURA 60, COMPRIMENTO MÍNIMO 1,40 M, TIPO MANGA LONGA, COMPRIMENTO MÍNIMO DA MANGA 0,65 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL P/FLUÍDOS, PERMEÁVEL AO AR, MATERIAL SMS, POLIPROPILENO, TIPO USO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL. UNIDADE AJUSTADO. FORMA DE APRESENTAÇÃO DO FABRICANTE. Valor R\$ 3,97 com esse valor vocês não receberam a gramatura solicitada, um avental não estéril gr 0 é no minimo R\$ 8,00

Atenciosamente,
Elisangela



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
SEÇÃO CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Parte nº 36/2019/SCAMMH

Brasília - DF, 31 de janeiro de 2019.

Do: Chefe da Seção Central de Abastecimento de Material Medico Hospitalar

Ao: Pregoeiro - SC Klinger - Seção de Licitações

Assunto: **Resposta a Parte nº 49/2019/SEÇ LCTC**

1. Versa o presente expediente sobre a resposta a **Parte nº 49/2019/SEÇ LCTC** referente ao pedido de Esclarecimento da empresa **VITA MEDICAL**, Pregão Eletrônico nº 65/2018.
2. Em atenção ao questionamento, informo-vos que o item deve ser **cancelado** em virtude do descritivo estar incorreto, não proporcionando a clareza necessária para a aquisição. Além disso, o item será incluso posteriormente em outro pregão.

LUCIANE CORRÊA DA ROSA - 1º Ten OFT EB
Chefe da Seção Central de Abastecimento de Material Médico- Hospitalar



Documento assinado eletronicamente por **Luciane Correa da Rosa, Chefe Substituto**, em 31/01/2019, às 09:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **1439077** e o código CRC **EC1AEB88**.



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Parte nº 76/2019/SEÇ LCTC

Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2019.

Do: Pregoeiro - SC Klinger - Seção de Licitações

Ao: Sr Chefe da Seção Central de Abastecimento de Material Médico-Hospitalar do HFA

Assunto: Esclarecimento Pregão 65/2018- HFA

Anexo: Pedidos de Esclarecimento ZAMMI (1443191) e IMPERIAL (1443192)

1. Solicito a V. S^a analisar o Pedido de esclarecimento anexo, enviado pela empresa ZAMMI e IMPERIAL.

2. Peço urgência no envio da análise supracitada, tendo em vista que o pregão terá a sua abertura no dia 05/02, às 09:00 horas.

3. Quaisquer dúvidas, entrar em contato com o SC KLINGER no ramal 2407.

Atenciosamente,

KLINGER SANTIAGO DOS SANTOS

Pregoeiro



Documento assinado eletronicamente por **Klinger Santiago dos Santos, Pregoeiro(a)**, em 04/02/2019, às 08:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **1443185** e o código CRC **DA68855C**.

Zimbra

klsantos@hfa.mil.br

Esclarecimentos PE: 65/2018

De : Danielle Santos - LICITAÇÃO ZAMMI-LABCOR <licitacao01@zammi.com.br>

Sex, 01 de fev de 2019 14:43

📎 1 anexo

Assunto : Esclarecimentos PE: 65/2018

Para : licitacao@hfa.mil.br

Responder para : licitacao01@zammi.com.br

Sr. Pregoeiro, boa tarde,

Solicito esclarecimentos para os itens 82 e 83, referente ao Pe: 65/2018 - Hospital das Forças Armadas.

A marca Zammi Atende perfeitamente ao descritivo dos itens e estão sendo citadas apenas as marcas Edwards e Gabimed.


Seria por conta de uma padronização já existente?

Temos Enfermeiros especialistas no produto, que estão à disposição para a padronização e amostras.

Aguardamos retorno.

Atenciosamente,

--

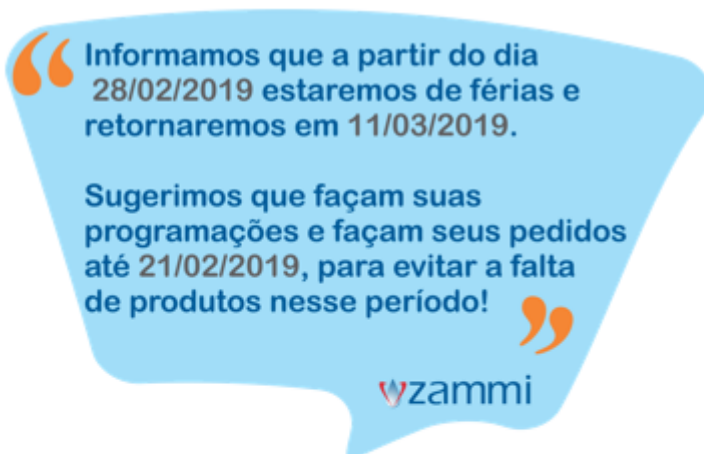

Danielle Santos

Departamento de Licitações / Comercial

✉ Licitacao01@zammi.com.br / Comercial@zammi.com.br

Daniellesantos@zammi.com.br

☎ 2677-1579



Preserve o meio ambiente. Antes de imprimir esta mensagem, verifique se é realmente necessária.



Pregão HFA <pregaohfa@gmail.com>

ENC: Pedido de Esclarecimento

2 mensagens

Vendas1 - Imperial Medicamentos <vendas1@imperialmed.com.br>
Para: pregaohfa@gmail.com, Valter - Imperial Med <valter@imperialmed.com.br>

1 de fevereiro de 2019 15:35

De: Vendas1 - Imperial Medicamentos [mailto:vendas1@imperialmed.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 15:30
Para: 'licitacao@hfa.mil.br'; 'Valter - Imperial Med'; 'Kelly - Imperial Medicamentos'
Assunto: Pedido de Esclarecimento

S.r. Pregoeiro, boa tarde !!!

Venho através desse solicitar, esclarecimento para o item 82 e 83, referente ao Pregão Eletrônico 65/2018 do Hospital das Forças Armadas.

Á Imperial Hospitalar irá cotar a marca Zammi, a mesma atende ao descritivo do edital, e que os cabos faz conexões com os monitores do HFA(DIXTAL,NIHON,GEI NELLCOR).

Na especificação do edital cita somente as marcas EDWARDS,GABMED. Caso a Imperial Hospitalar seja detentora do menor valor, vai ser solicitado para teste ? informamos que hoje dispomos de enfermeiros especialista no produto, que estão disposto para padronização e amostra,aguadamos o retorno.

Por favor, confirmar o recebimento deste!

Att,



Pregão HFA <pregaohfa@gmail.com>

1 de fevereiro de 2019 16:31

Para: Vendas1 - Imperial Medicamentos <vendas1@imperialmed.com.br>

Boa tarde,

Prezado licitante.

Em que pese o edital fazer referência somente às marcas somente as marcas EDWARDS,GABMED, este pregoeiro entende que, atendendo às exigências de menor preço e compatíveis com as necessidades do Hospital, não há qualquer impedimento quanto à participação da empresa. Vale ressaltar que a análise técnica da proposta de preços e eventual amostra será realizada pelo setor demandante, que verificará a compatibilidade entre o produto ofertado e as condições exigidas em edital.

Informo que este email será encaminhado para o setor técnico para análise e tão logo recebamos resposta, esta será tempestivamente encaminhada.

Atenciosamente,

Klinger Santiago - Pregoeiro
Hospital das Forças Armadas
(61) 3966-2407
pregaohfa@gmail.com / licitacao@hfa.mil.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
SEÇÃO CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Parte nº 40/2019/SCAMMH

Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2019.

Do: Chefe da Seção Central de Abastecimento de Material Medico Hospitalar

Ao : Pregoeiro - Seção de Licitações

Assunto: Resposta às Partes nº 76/2019/SEÇ LCTC

1. Versa o presente expediente sobre os pedidos de esclarecimentos das empresas licitantes referentes ao Edital do Pregão Eletrônico nº 65/2018-HFA.
2. Com relação ao pedido de esclarecimento das empresas ZAMMI e IMPERIAL, referente aos itens 82 e 83 (kit transdutor descartável), informo-vos que devem ser **compatíveis** com os modelos de monitores existentes no hospital (Dixtal, Nihon, GE e Nellcor). Atualmente, utilizamos as marcas Edwards e Gabmed. A empresa licitante vencedora dos itens deverá fornecer amostra para verificação de compatibilidade com os monitores do hospital.

ÂNGELA ALVES MENDES - 1º Ten OFT EB
Chefe da Seção Central de Abastecimento de Material Médico- Hospitalar



Documento assinado eletronicamente por **Luciane Correa da Rosa, Chefe Substituto**, em 04/02/2019, às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **1443485** e o código CRC **8FD7E6A8**.